


# DentalFantom


Testfantom til konstantstest af intraoralt røntgenudstyr op til 70 kV



Drej tubus opad og læg DentalFantom oven på firkanttubus, læg billedpladen oven på. Eksponer med de valgte værdier.

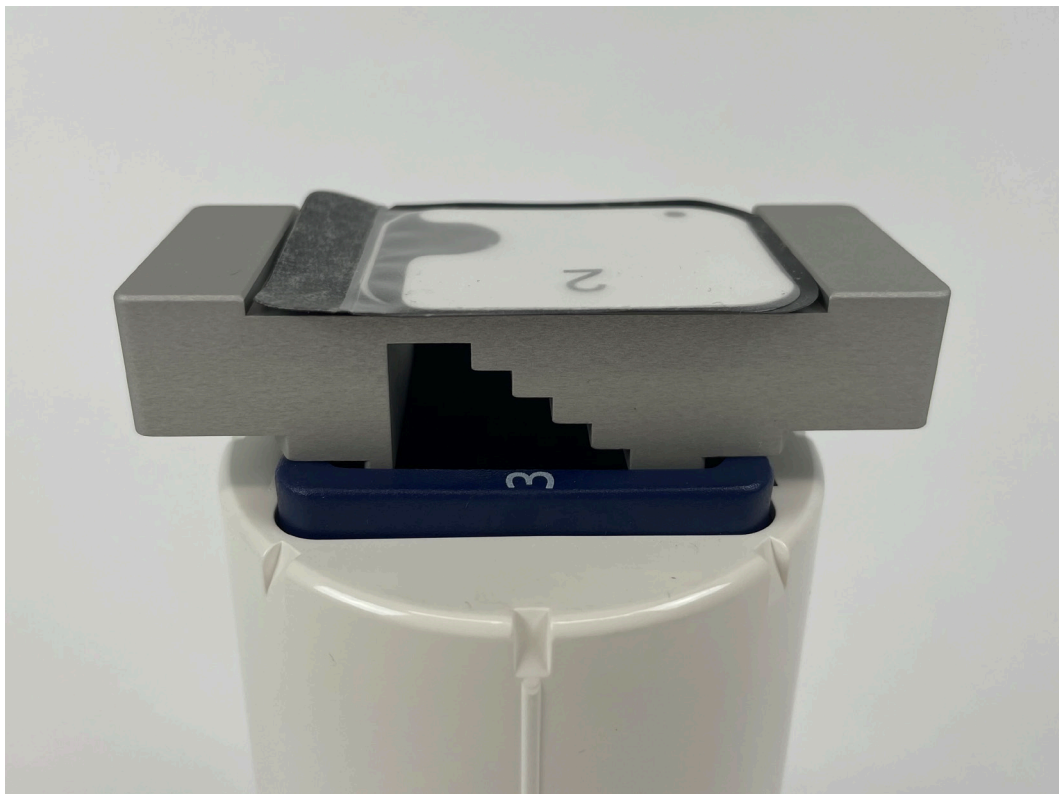

Her uden firkanttubus

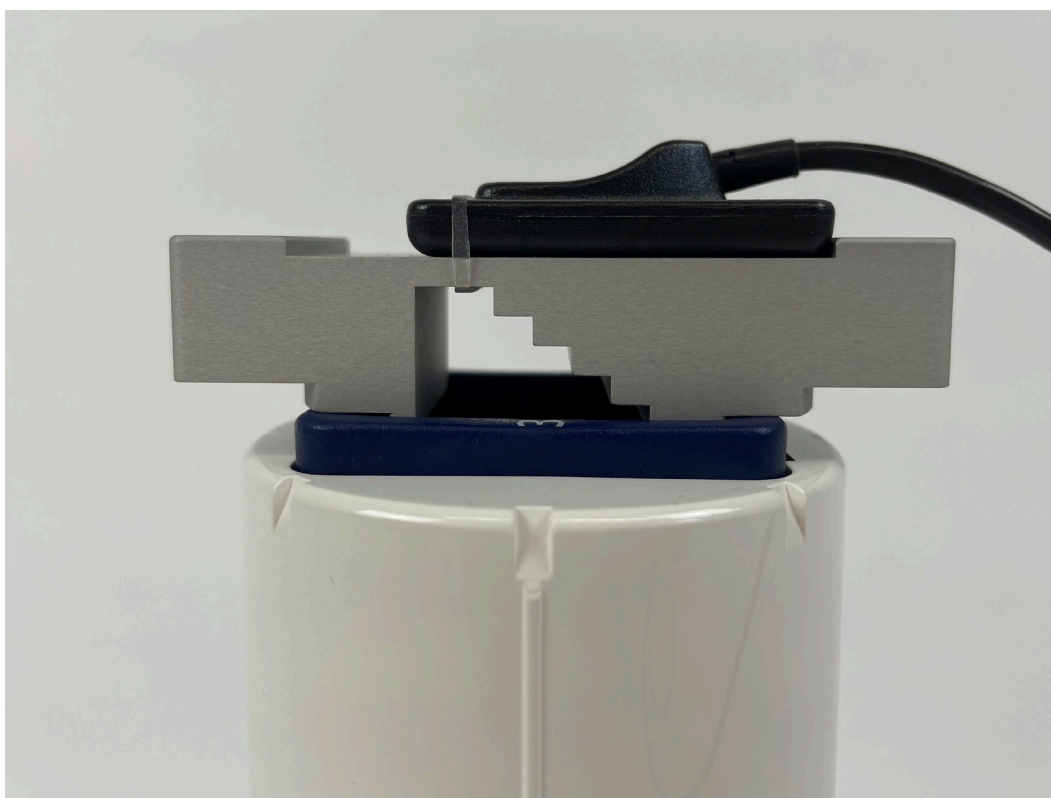

Her med sensor.

DentalFantom kan rengøres med sæbevand eller sprit.

Der henvises til vedlagte vejledninger fra SIS vedr. optagelser.